


Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa PRz.

Posiadamy do przekazania zbędny w naszej Katedrze:

Dyfraktometr rentgenowski typu DRON 2.0 o nr inwentarz.: T-PRz-664-455

Urządzenie sprawne. Wymaga kalibracji.

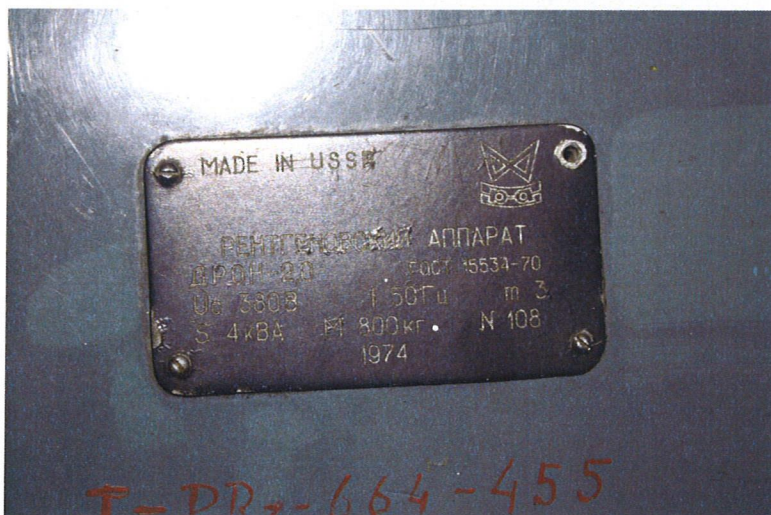

Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa PRz.


Posiadamy do przekazania zbędny w naszej Katedrze:

Piec elektryczny komorowy PEK 100. Nr inwent.: T-PRz-450-144

Urządzenie sprawne. Bez regulatora i termopary.





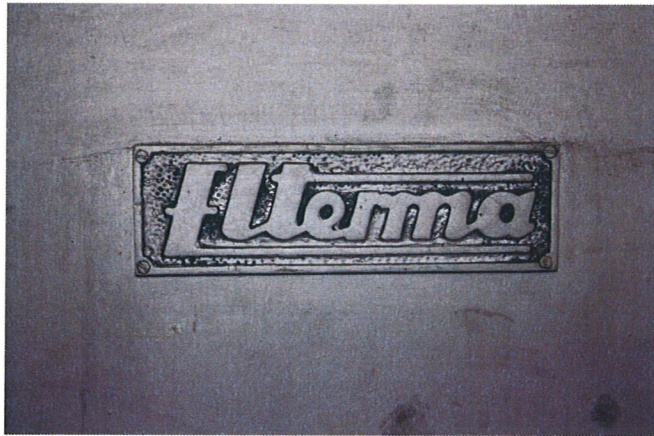

Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa PRz.

Posiadamy do przekazania zbędną w naszej Katedrze:

Tokarka 1A616 Nr inwent.: PN-PRz-MG-pn7-109

Urządzenie sprawne.

